


# レールダル・シリコン・レサシテータ 分解図

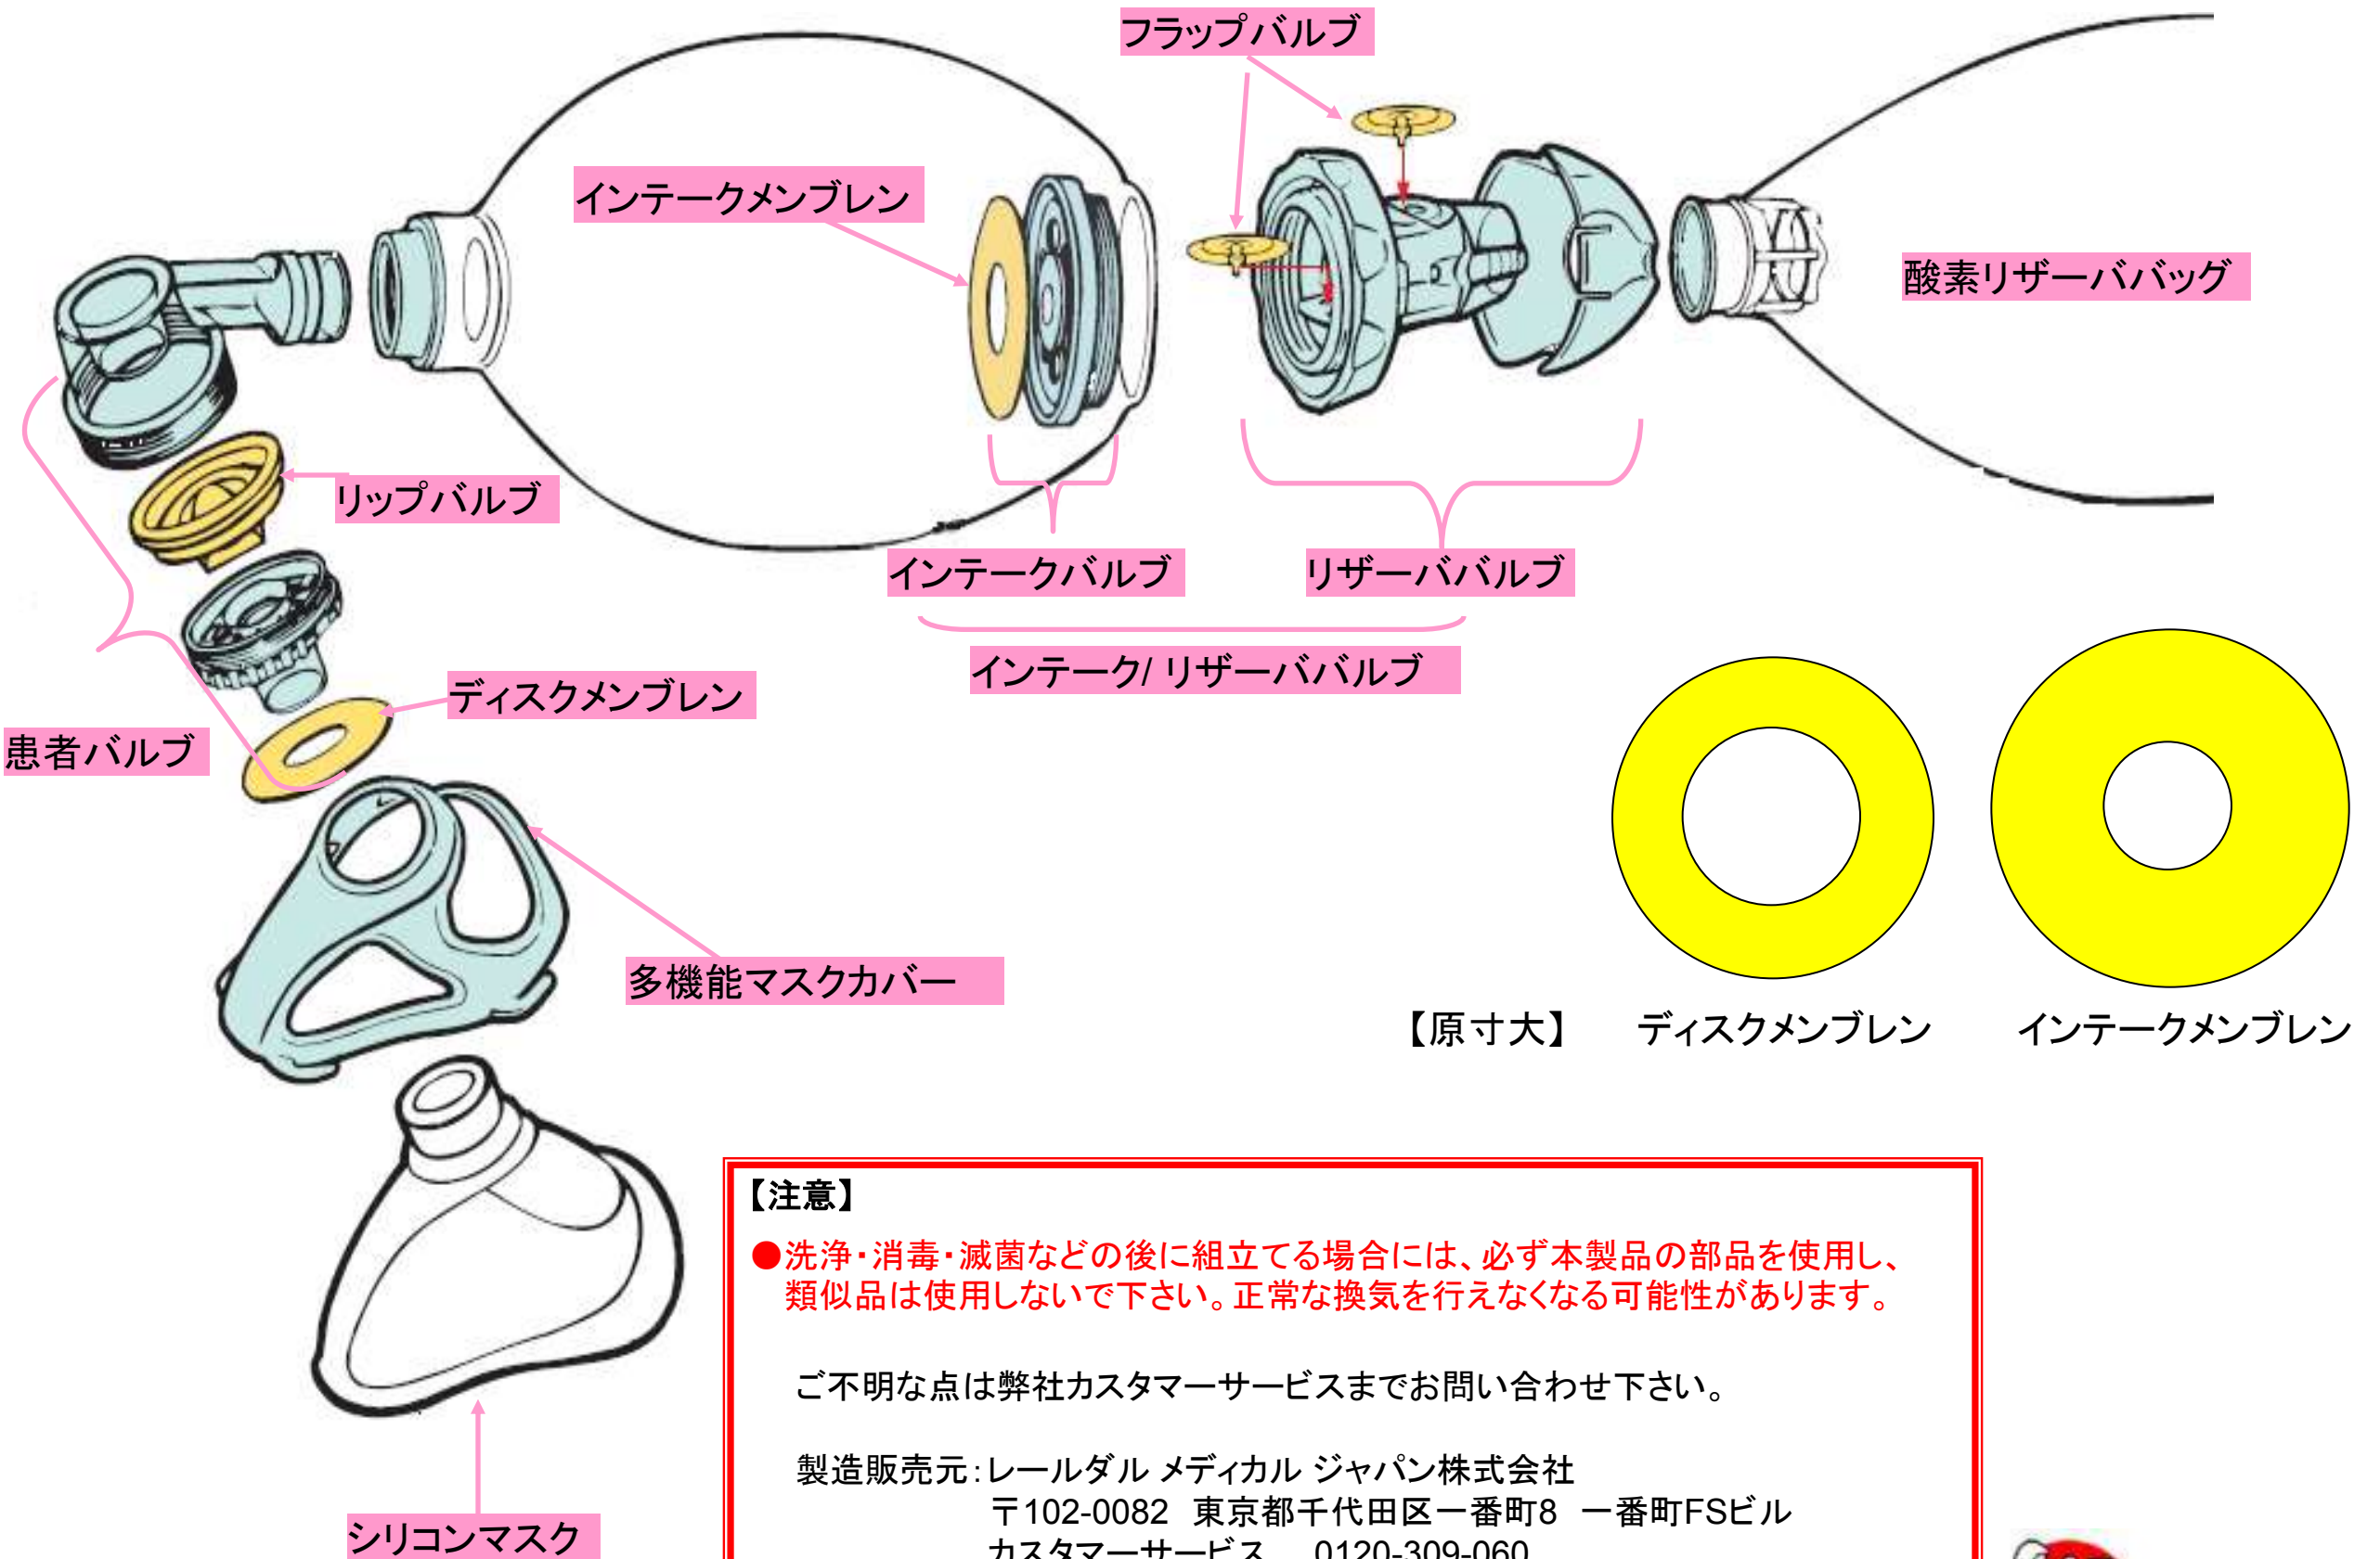

## 【注意】

- 洗浄・消毒・滅菌などの後に組立てる場合には、必ず本製品の部品を使用し、類似品は使用しないで下さい。正常な換気を行えなくなる可能性があります。

ご不明な点は弊社カスタマーサービスまでお問い合わせ下さい。

製造販売元: レールダル メディカル ジャパン株式会社

〒102-0082 東京都千代田区一番町8 一番町FSビル

カスタマーサービス 0120-309-060



**Laerdal**

helping save lives